

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Радиометры РКС-АТ1329

Назначение средства измерений

Радиометры РКС-АТ1329 (далее – радиометры) предназначены для измерений:

- суммарной альфа-активности счётных образцов;
- суммарной бета-активности счётных образцов;

- активности, плотности потока, внешнего альфа-излучения и/или бета-излучения источников типа 1П9, 2П9, 3П9, 1С0, 2С0, 3С0.

Описание средства измерений

Принцип действия радиометров основан на использовании интеллектуальных сцинтилляционных блоков детектирования альфа-излучения и бета-излучения.

Радиометры РКС-АТ1329 имеют три модификации: РКС-АТ1329, РКС-АТ1329А, РКС-АТ1329В.

Для регистрации альфа-излучения и/или бета-излучения в составе радиометра РКС-АТ1329 используется блок детектирования альфа-бета-излучения БДКС-07, выполненный с применением сцинтилляционного «фосвич»-детектора (пластмассовый сцинтилляционный детектор диаметром 60 мм и высотой 1 мм с нанесённым слоем ZnS(Ag)). Для регистрации альфа-излучения в радиометре РКС-АТ1329А используется блок детектирования альфа-излучения БДКА-07, выполненный с применением сцинтилляционного детектора ZnS(Ag) диаметром 60 мм. Для регистрации бета-излучения в радиометре РКС-АТ1329В используется блок детектирования бета-излучения БДКБ-07, выполненный с применением пластмассового сцинтилляционного детектора диаметром 60 мм и высотой 1 мм.

Алгоритм работы радиометра обеспечивает непрерывность процесса измерения, вычисление «скользящих» средних значений и оперативное представление получаемой информации на экране ПК, статистическую обработку результатов измерений и оценку статистических флюктуаций в темпе поступления сигналов от детектора.

Для повышения стабильности измерений в блоках детектирования применена система светодиодной стабилизации измерительного тракта, которая одновременно обеспечивает проверку работоспособности всего тракта в процессе работы.

Радиометр РКС-АТ1329 предназначен для измерений:

- суммарной альфа-активности и/или суммарной бета-активности счётных образцов на основе аэрозольных аналитических фильтров типа АФА-РМП и АФА-РСП (далее – фильтры);
- суммарной альфа-активности и/или суммарной бета-активности «толстослойных» счётных образцов, приготовленных из вещества пробы (например, путём выпаривания либо любым другим методом, обеспечивающим получение «толстого» образца);
- суммарной альфа-активности и/или суммарной бета-активности «тонкослойных» счётных образцов, приготовленных из вещества пробы (например, путём электролитического осаждения);
- плотности потока альфа-частиц и/или плотности потока бета-частиц с загрязнённых поверхностей путём измерения счётных образцов, приготовленных из тампонов (ваты, марли, фильтровальной бумаги) для снятия мазка с загрязнённых радиоактивными веществами поверхностей;

- активности, внешнего альфа-излучения и/или бета-излучения источников типа 1П9, 2П9, 3П9, 1С0, 2С0, 3С0.

Радиометр РКС-АТ1329А предназначен для измерений:

- суммарной альфа-активности счётных образцов на основе фильтров;

- суммарной альфа-активности «толстослойных» счётных образцов, приготовленных из вещества пробы (например, путём выпаривания либо любым другим методом, обеспечивающим получение «толстого» образца);
 - суммарной альфа-активности «тонкослойных» счётных образцов, приготовленных из вещества пробы (например, путём электролитического осаждения);
 - плотности потока альфа-частиц с загрязнённых поверхностей путём измерения счётных образцов, приготовленных из тампонов (ваты, марли, фильтровальной бумаги) для снятия мазка с загрязнённых радиоактивными веществами поверхностей;
 - активности, внешнего альфа-излучения источников типа 1П9, 2П9, 3П9.
- Радиометр РКС-АТ1329В предназначен для измерений:
- суммарной бета-активности счётных образцов на основе фильтров;
 - суммарной бета-активности «толстослойных» счётных образцов, приготовленных из вещества пробы (например, путём выпаривания либо любым другим методом, обеспечивающим получение «толстого» образца);
 - суммарной бета-активности «тонкослойных» счётных образцов, приготовленных из вещества пробы (например, путём электролитического осаждения);
 - плотности потока бета-частиц с загрязнённых поверхностей путём измерения счётных образцов, приготовленных из тампонов (ваты, марли, фильтровальной бумаги) для снятия мазка с загрязнённых радиоактивными веществами поверхностей;
 - активности, внешнего бета-излучения источников типа 1С0, 2С0, 3С0.

Общий вид радиометров приведён на рисунке 1.

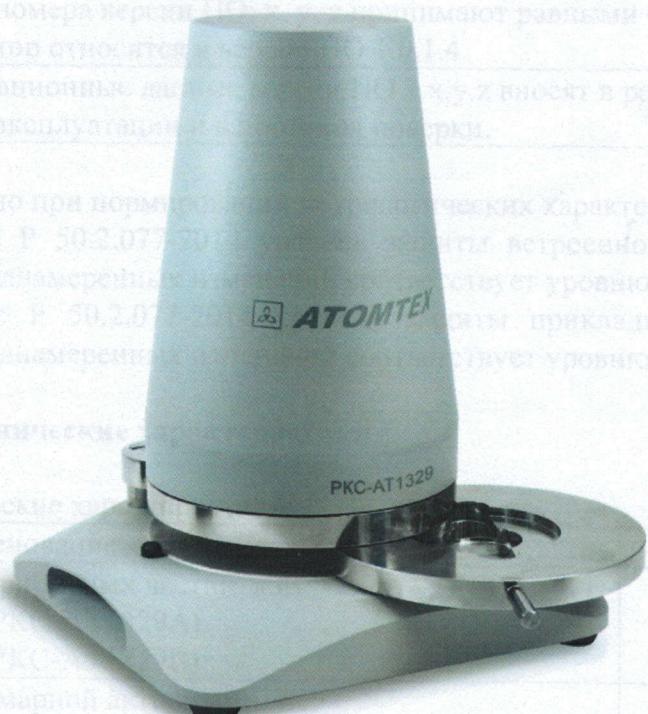


Рисунок 1 – Общий вид радиометров

Защита от несанкционированного доступа осуществляется пломбированием радиометров в виде наклеек из разрушаемой пленки, устанавливаемых на нижних поверхностях оснований корпусов.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) радиометров состоит из встроенного и внешнего (прикладного).

Встроенное ПО устанавливается на стадии производства в блоки детектирования альфа-излучения и бета-излучения. Доступа к цифровому идентификатору ПО нет. Изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования изготовителя.

Внешнее ПО состоит из программы «AT1329», устанавливаемой на персональный компьютер, и предназначено для управления радиометрами. Внешнее ПО является метрологически значимым.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

Идентификационные данные метрологически значимого внешнего ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимого ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Прикладное ПО	
Идентификационное наименование ПО	AT1329.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0.1.4; 1.x.y.z*
Цифровой идентификатор ПО	86bf6bd7e0c359111c436c430cae87f8**
Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода	MD5

* x, y, z – составная часть номера версии ПО: x, y, z принимают равными от 0 до 99.
** Цифровой идентификатор относится к версии ПО 1.0.1.4.

Примечание – Идентификационные данные версии ПО 1.x.y.z вносят в раздел «Свидетельство о приемке» руководства по эксплуатации и в протокол поверки.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

В соответствии с Р 50.2.077-2014 уровень защиты встроенного ПО радиометров от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий».

В соответствии с Р 50.2.077-2014 уровень защиты прикладного ПО «AT1329» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний».

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон энергий регистрируемых частиц, кэВ:	
- α-канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329A)	от 3000 до 7000
- β-канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329B)	от 155 до 3540
Диапазон измерений суммарной активности, Бк:	
- α-канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329A)	от 0,01 до 10^4
- β-канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329B)	от 0,1 до 10^4
Диапазон измерений внешнего излучения, с^{-1} :	
- α-канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329A)	от 0,1 до 10^5
- β-канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329B)	от 0,1 до 10^5
Диапазон измерений плотности потока, $\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$:	
- α-канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329A)	от 0,6 до $6 \cdot 10^6$
- β-канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329B)	от 0,6 до $6 \cdot 10^6$

Наименование характеристики	Значение
Скорость счёта импульсов, обусловленная фоном гамма-излучения, с^{-1} , не более:	
- α -канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329A)	0,001
- β -канал (PKC-AT1329, PKC-AT1329B)	0,750
Чувствительность, $\text{Бк}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$, не менее:	
- к α -излучению (источник типа ЗП9) (PKC-AT1329, PKC-AT1329A)	0,30
- к β -излучению (источник типа ЗС0) (PKC-AT1329, PKC-AT1329B)	0,30
Время установления рабочего режима, мин, не более	10
Время непрерывной работы, ч, не менее	24
Нестабильность показаний, %, не более	3
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении суммарной альфа-активности и/или суммарной бета-активности счётных образцов на основе фильтров, суммарной альфа-активности и/или суммарной бета-активности «толстослойных» образцов, суммарной альфа-активности и/или суммарной бета-активности «тонкослойных» образцов, альфа-активности и/или бета-активности эталонных источников, %	± 20
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении плотности потока альфа-частиц и/или плотности потока бета-частиц, внешнего альфа-излучения и/или внешнего бета-излучения, %	± 20
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности при измерении внешнего альфа-излучения при воздействии сопутствующего гамма-излучения с мощностью дозы 10 мкЗв/ч , %	± 2
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности при измерении внешнего альфа-излучения при воздействии сопутствующего бета-излучения источника $^{90}\text{Sr}+^{90}\text{Y}$ с внешним излучением не менее $3 \cdot 10^3 \text{ с}^{-1}$, %	± 2
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности при измерении внешнего бета-излучения при воздействии сопутствующего гамма-излучения с мощностью дозы 10 мкЗв/ч , %	± 5
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности при измерении внешнего бета-излучения при воздействии сопутствующего альфа-излучения источника ^{239}Pu с внешним излучением не менее $3 \cdot 10^3 \text{ с}^{-1}$, %	± 5
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %:	
- при изменении температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 20 °C до плюс 50 °C относительно нормальных условий	± 10
- при воздействии относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги	± 5
- при воздействии постоянных магнитных полей и переменных полей сетевой частоты напряженностью до 400 А/м	± 10
- при изменении напряжения питания от 195 до 253 В относительно номинального значения 230 В	± 5
Нормальные условия измерений:	
- температура окружающего воздуха, °C	от +15 до +25
- относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 86 до 106,7

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм, не более:	
- длина	230
- ширина	230
- высота	290
Масса, кг, не более:	
- PKC-AT1329	22
- PKC-AT1329A	10
- PKC-AT1329B	22
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от -20 до +50
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более	95
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

Знак утверждения типа

наносится на пленку с липким слоем и ламинацией, расположенную на задней стенке корпуса радиометра, и на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность

Наименование, тип	Обозначение	Количество на исполнение			Примечание
		-	01	02	
Радиометр PKC-AT1329	ТИАЯ.412128.004	1	-	-	
Радиометр PKC-AT1329A	ТИАЯ.412128.004-01	-	1	-	
Радиометр PKC-AT1329B	ТИАЯ.412128.004-02	-	-	1	
Компьютер персональный		1	1	1	По заказу
Кабель USB	ТИАЯ.685621.427	1	1	1	
Программа «AT1329»	ТИАЯ.00371-01	1	1	1	На внешнем носителе данных
Программа «AT1329». Руководство оператора	ТИАЯ.00371-01 34	1	1	1	
Комплект принадлежностей	ТИАЯ.412914.069	1	1	1	
Руководство по эксплуатации		1	1	1	
Методика поверки	МРБ МП.2802-2018	1	1	1	
Методика измерений	МВИ.МН 6097-2018	1	1	1	По заказу
Методика измерений	МВИ.МН 6098-2018	1	1	1	По заказу
Методика измерений	МВИ.МН 6099-2018	1	1	1	По заказу

Проверка

осуществляется по документу МРБ МП.2802-2018 «Радиометры РКС-АТ1329. Методика поверки», утверждённому БелГИМ 28 августа 2018 г.

Основные средства поверки:

- рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ 8.033-96 - источники альфа-излучения радиометрические типа 1П9, 2П9, 3П9 интенсивностью внешнего излучения от 1 до $1 \cdot 10^5 \text{ c}^{-1}$, погрешность не более $\pm 6\%$;
- рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ 8.033-96 - источники бета-излучения радионуклидные типа 1С0, 2С0, 3С0 интенсивностью внешнего излучения от 1 до $1 \cdot 10^5 \text{ c}^{-1}$, погрешность не более $\pm 6\%$.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к радиометрам РКС-АТ1329

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1034н от 09 сентября 2011 г. «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности»

ТУ BY 100865348.043-2018 Радиометры РКС-АТ1329. Технические условия

ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия

ГОСТ 17225-85 Радиометры загрязнённости поверхностей альфа- и бета-активными веществами. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 8.033-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников

Изготовитель

Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»), Республика Беларусь

Адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5

Телефон/факс: (+375 17) 2928142, (+375 17) 2882988

Web-сайт: www.atomtex.com

E-mail: info@atomtex.com

Испытательный центр

Экспертиза проведена Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: +7 (812) 251-76-01, факс: +7 (812) 713-01-14

Web-сайт: <http://www.vnijm.ru>

E-mail: info@vnijim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA RU 311541 от 23.03.2016 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов



М II

» anfertig

2019 г.